

Łasin, dnia 17.05.2019 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Im. Macieja z Miechowa  
86 – 320 Łasin  
ul. Radzyńska 4

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
86-320 ŁASIN

tel./fax. (0-56) 466 42 51

## WSZYSCY WYKONAWCY

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na: „Analizator jonoselektywny z gazometrią - zakup i dostawa do Laboratorium SP ZOZ Łasin”

Nr sprawy: 12/2019

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie udzielam wyjaśnień do treści zapytań, które wpłynęło dnia 15.05.2019 r.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

### Pytania do załącznika nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

**poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści analizator z ekranem LCD i klawiaturą do obsługi urządzenia?

**Odp. Nie dopuści**

**poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści analizator z parametrami mierzonymi w zakresach:

PH 6.900-7.900

PCO2 8.0-150.0mmHg

PO2 10-700mmHg


Hct 10-70%

Na+ 80-200mmol/L

K+ 1.0-20.0mmol/L

Ca++ 0.25-5.00mmol/L

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści**

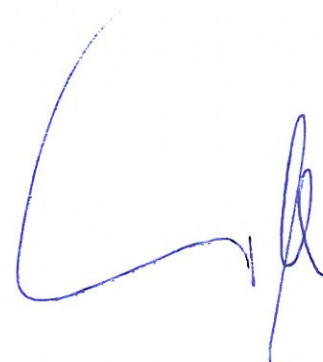

**poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez wyliczanej luki anionowej i pO<sub>2</sub>/FIO<sub>2</sub>?

**Odp. Nie**

**poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez wprowadzanego miejsca pobrania próbki?

**Odp. Nie**

**poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści analizator z pamięcią 64 wyników pacjenta + 93 wyniki kontroli jakości dla każdego z 3 poziomów?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuści**

**poz. 14:**

Czy Zamawiający dopuści analizator bez portu usb?

**Odp. Nie**

**poz. 13:**

Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową transmisją danych?

**Odp. Nie**

  
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie  
Mariusz Topolewski